




中检西南计量有限公司

校准证书




中国认可
校准证书
CALIBRATION
CNAS 18000

证书编号: 9025002556



客户名称 江苏省精创电气股份有限公司
 联络信息 江苏省徐州市
 样品名称 温湿度记录仪
 型号/规格 RCW-360
 出厂编号 80855 10841 99125 54327
 制造单位 江苏省精创电气股份有限公司
 接收日期 2022 年 02 月 16 日
 校准日期 2022 年 02 月 16 日

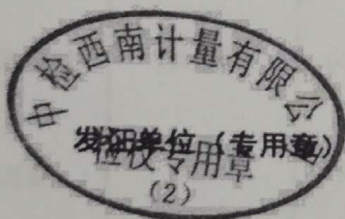

批准人 朱玉平

部长

核验员 陈丽

校准员 赵伟



发布日期: 2022 年 02 月 16 日

地址: 中国云南·昆明市西山区永昌路142号

联系电话: 0871-64105422

传真: 0871-64577518

监督电话: 0871-64636302

邮编: 650034

网址: <http://www.ynottc.com>

电子邮件: kfzx@ynottc.com



扫一扫查真伪

第 1 页共 3 页



中检西南计量有限公司

证书编号: 9025002556



1. 我公司仅对加盖“中检西南计量有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本证书。
3. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
4. “委托方”、“联络信息”由委托方提供, “型号/规格”、“出厂编号(或设备编号)”以及“制造单位”为仪器上标注。
5. 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定, 由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。
6. 本次校准项目/参数的详细认可范围请查看CNAS网站中注册编号L8200的证书附件, 超出范围的内容未被认可。

校准环境条件及地点:

温度: 20.4 °C 地点: 云南省昆明市永昌路142号104室
湿度: 52 %RH 其他:

本次校准所依据/参照的技术文件(代号、名称):

JJF(冀) 3004-2019《数字温湿度计校准规范》

JJF(苏) 95-2010《数字温度计校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具/标准物质

名称	编号	测量范围	不确定度或准确度等级 或最大允许误差	溯源机构 及证书号	有效期至
精密露点仪	H01200304	露点:(-10~20)°C DP; 温度:(0~30)°C	露点: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ DP; 温度: $U=0.01^{\circ}\text{C}$, $k=2$	中国计量科学研究院 检定HXsp2021-11275/校准RGjc2021-11870	2022-06-06
温湿度检定箱	2100517	温度:(15~30)°C; 湿度:(40~80)%RH	温度: $U=0.05^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度: $U=0.5\%\text{RH}$, $k=2$	中检西南计量有限公司 校准82101014397	2022-06-08
标准铂电阻温度计	172688	(-189.3442~419.527)°C	二等	华北国家计量测试中心 检定RA20H-AK000177	2022-10-12
高精度数字测温仪	80252103	(-80~600)°C	$U_{\text{rel}}=1\times 10^{-5}$, $k=2$	北京市计量检测科学研究院 校准RA21S-CA100514	2022-09-23
恒温槽	9467	(-80~90)°C	$U=0.003^{\circ}\text{C}$, $k=2$	中检西南计量有限公司 校准818011642	2022-10-11


溯源性: 本次校准使用的计量标准器具均可溯源至国家计量基准/测量标准和国际单位制(SI)。

其他说明: /



中检西南计量有限公司

证书编号: 9025002556



校准数据/结果

温度 (°C)		湿度 (%RH)	
标准值	示值误差	标准值	示值误差
-20.0	0.2	40.1	0.4
5.1	0.0	60.1	-0.3
25.2	-0.2	80.2	-0.5
测量结果的不确定度: $U = 0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$		测量结果的不确定度: $U = 2.3\%\text{RH}$ $k=2$	

建议复校时间间隔12个月

